



**D/20/2018/A**

*L.dz. DZP: 53/2018*

Opole, 15.01.2019 r.

**Do:  
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**


Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwaną dalej „ustawą”, pn.: **Zakup wyposażenia medycznego**.

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania dotyczącego przedmiotowego postępowania:

Dotyczy opisu wymaganych parametrów technicznych – **załącznik nr 1c do SIWZ (lampa zabiegowe)**:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy, której kopuła wyposażona jest w dwa uchwyty niesterylne (kolor zieleni medyczna – zwracamy uwagę, że kolor nie ma wpływu na walory kliniczne lampy); Lampa wyposażona w 88 diod LED o żywotności diod 50 000 h, uchwyt sterylny umieszczony centralnie, z poborem mocy 60W, głębokością oświetlenia 1100 mm i regulowaną średnicą plamy świetlnej 220-340mm? – dotyczy l.p. 1a, 1e, 1f, 1g, 1h

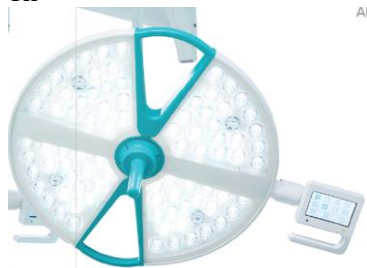

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i z wcześniej udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy z kamerą HD lub przygotowania instalacyjnego lampy pod montaż kamery w późniejszym czasie?

**Odpowiedź: Nie - zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 45 dni? Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do lamp od naszych poddostawców spowodowane zbliżającym się końcem roku. Dodatkowym argumentem jest spiętrzenie zamówień w ostatnim kwartale roku, związane między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.

**Odpowiedź: Nie**

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy wyposażonej w jeden panel (gładka i łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia (odlew aluminiowy); diody osłonięte poliwęglanem odpornym na zarysowania) złożony z 36 diod LED. Kopuła bez dodatkowych uchwytów brudnych, które nie są niezbędne przy zabiegach służących kształceniu w zakresie anatomii. Lampa wyposażona w uchwyt sterylny umieszczony centralnie (3 sztuki dostarczane łącznie z lampą), służący do precyzyjnego pozycjonowania lampy. Poniżej poglądowa wizualizacja. – dotyczy l.p. 1a



**Odpowiedź: Tak**

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze wskaźnikiem Ra=95, gwarantującym wysoką jakość oddawania barw? – dotyczy l.p. 1c

**Odpowiedź: Nie - zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy ze stałą średnicą plamy świetlnej o wysokiej wartości 240mm? – dotyczy l.p. 1 e

**Odpowiedź: Nie - zgodnie z SIWZ**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z głębokością oświetlenia 1400mm? Duży zasięg ramion oferowanej lampy i możliwości manewrowania umożliwiają dowolne ustawienie lampy i uzyskanie optymalnej pozycji świetlnej.

**Odpowiedź: Nie - zgodnie z SIWZ**

Zgodnie z pkt. 12.6. SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, treść przygotowywanych przez Państwa ofert będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, jednakże terminy składania i otwarcia ofert zostały wydłużone o czas niezbędny w dniu dzisiejszym pismem *Pytania i odpowiedzi nr 4 (L.dz. DZP: 52/2019)*.

Tym samym dotychczasowy **termin składania ofert nie ulega zmianie**, tj.: *osiemnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego [ 18.01.2019 ] roku, do godziny dziesiątej [ 10:00 ], otwarcie ofert osiemnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego [ 18.01.2019 ] roku o godz. dziesiątej trzydzieści [ 10:30 ]*, Dział Zamówień Publicznych, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pokój nr 2-3.

**KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych**

*mgr Emil Krzesaj*